

产品名称：程控医用漏电流测试仪


产品型号：CS1875FJ-05K




性能特点

- 采用 5.6 寸 TFT (640×480) 彩色液晶屏显示彩显示，设置参数及测试参数，显示内容醒目，丰富。
- 测试仪可自动把测试结果以 EXCEL 表格的格式存储到 U 盘中。
- 输出电源 50Hz、60Hz 可切换
- 可通过 U 盘升级软件。
- 漏电流测试人体网络 GB9706.1-2020(IEC60601-1: 2012) GB4793.1-2007(IEC61010-1)标准。
- 漏电流提供 AC,AC+DC,PEAK,DC 四种检波方式。
- 测试时可显示各个开关的切换状态和测试人体网络。
- 提供测试所需的辅助电源，满足最小漏电流 10uA 的要求。
- 标配 PLC 接口，RS232,选配 RS485 接口。
- 符合检规：JJG1188-2022、JJG843-2022。


MD 人体网络

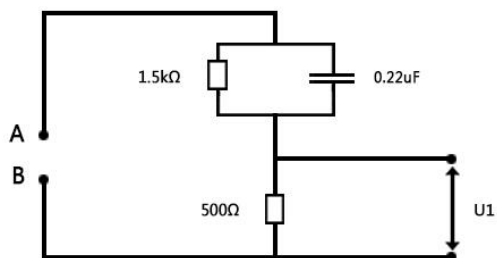


符合的标准: GB/T12113 (IEC60990)
GB4793.1 (IEC61010-1)

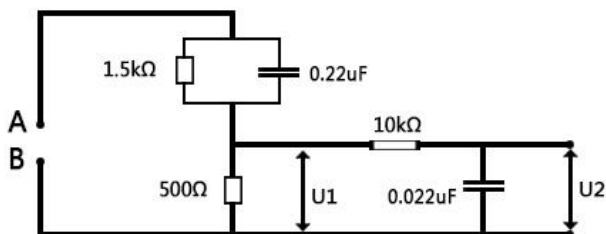


符合的标准: GB/T12113 (IEC60990)、GB4706.1 (IEC60335-1)、
GB4943.1 (IEC60950-1)、GB8898 (IEC60065)、GB4793.1 (IEC61010-1)、
GB7000.1 (IEC60598-1)

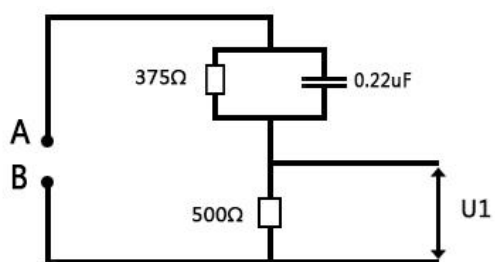


符合的标准: GB4793.1 (IEC61010-1)

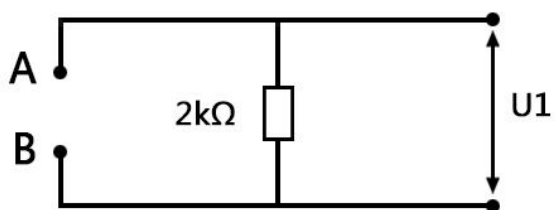

符合的标准: GB4943.1 (IEC60950-1)、
GB4793.1 (IEC61010-1)

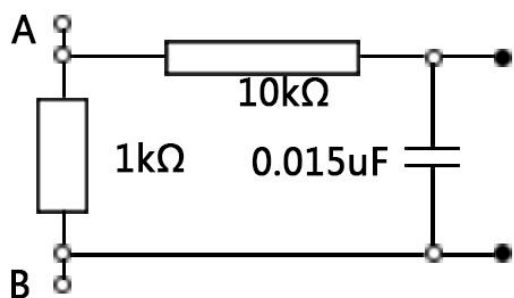

符合的标准: GB9706.1-2020 (IEC60601-1:2012)



符合的标准: GB9706.1-2020 (IEC60601-1:2012)

技术参数

型号			CS1875FJ-05K
技术参数	输出 电压	范围	30.0V ~ 300.0V
		精度	±（1%读值+5V）
		分辨率	0.1V
	最大输出功率		500VA
	电流档位		200uA、2mA、20mA（注：GB4793.1 无 200uA 档）
	检波方式		AC、RMS、PEAK、DC
	电流上限设定		0. 1uA~20.00mA
	电流下限设定		0~电流上限
	MD 人体网络		GB9706.1、GB4793.1
	电压上升时间		(0.0 ~ 999.9)s 0=电压上升时间关
	测试时间		(0.0, 0.3 ~ 999.9)s 0=连续测试
	间隔时间		(0.0 ~ 999.9)s 0=间隔时间关
	辅助 电压	范围	30.0V~300.0V
		精度	±（1%读值+5V）
		分辨率	0.1V
电流表	测量范围		0.1uA ~ 20.00mA
	分辨率		200uA 档：0.1uA 2mA 档：1uA、 20mA 档：10uA
	测量精度		±(1%+0.5%档位量程)
电压表	范围		30.0V~300.0V
	精度		±（1%读值+5V）
	分辨率		0.1V
一般规格	系统电源		110V/220V±10%，50Hz/60Hz±5%，5A
	使用环境		0℃～40℃,，(5～90)%RH，粉尘少
	系统重量（不含包装）		约30KG
	外型尺寸（mm）		(5U)长 510*宽 426*高 222